




Da: Assessoria GAB/Coordenação de Saúde Bucal	Para: Superintendência de Aquisição/SMS	CI: 574/2018/SMS	Data: 07/03/2018
---	--	------------------	---------------------

Prezada Senhora,

Tendo em vista Ci Nº 81/2018/Secretaria de Administração/Superintendência de Licitação datada de 06/03/2018, em relação ao Pregão nº 09/2018, segue no anexo parecer solicitado sobre os itens expressos nas propostas de fornecimento e preços das empresas ELISVANIA MATOS DONINI EIRELI – EPP e SALVI LOPES E CIA LTDA.

Atenciosamente,

Narciso Santana da Silva
Assessoria de Gabinete SMS/Várzea Grande

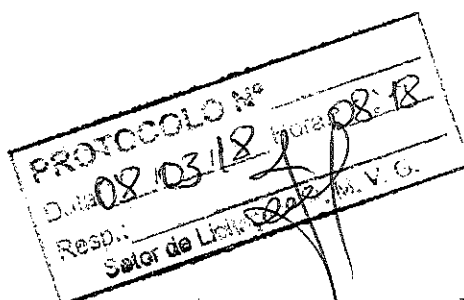

*Encaminhar
07/03/2018
08:52 hr*



Prefeitura Municipal de

VÁRZEA GRANDE



SECRETARIA DE SAÚDE

Empresa	Item	Descrição	Marca	Situação
ELISVANIA MATOS DONINI EIRELI -- EPP	12	Broca carbide cirúrgica 701	Quimidrol	Aceita
	24	Broca Gates nº 3 (28 mm)	MK LIFE	Aceita
	25	Broca Gates nº 3 (32 mm)	MK LIFE	Aceita
	28	Broca Largo nº 1 (28 mm)	MK LIFE	Aceita
	33	Broca Shofu tipo cilíndrica	MK LIFE	Aceita
	40	Dosador de água	Dentsply	Aceita

Empresa	Item	Descrição	Marca	Situação	Justificativa
SALVI LOPES E CIA LTDA	20	Broca Gates nº 1 (28 mm)	JOTA	Aceita	Atende às especificações do Edital.
	21	Broca Gates nº 1 (32 mm)	JOTA	Aceita	Atende às especificações do Edital.
	22	Broca Gates nº 2 (28 mm)	JOTA	Aceita	Atende às especificações do Edital.
	23	Broca Gates nº 2 (32 mm)	JOTA	Aceita	Atende às especificações do Edital.
	26	Broca Gates nº 4 (28 mm)	JOTA	Aceita	Atende às especificações do Edital.
	27	Broca Gates nº 4 (28 mm)	JOTA	Aceita	Atende às especificações do Edital.
	29	Broca Largo nº 1 (32 mm)	JOTA	Aceita	Atende às especificações do Edital.
	30	Broca Largo nº 2 (32 mm)	JOTA	Aceita	Atende às especificações do Edital.
	37	Cimento de ionômero de vidro fotopolimerizável	MAQUIRA	Não aceita	A marca não atende às especificações do edital quanto ao tipo de polimerização já que é autopolimerizável e o solicitado deve ser fotopolimerizável (segue foto da especificação do produto)
	38	Cimento de ionômero de vidro fotopolimerizável	MAQUIRA	Não aceita	A marca não atende às especificações do edital quanto ao tipo de polimerização já que é autopolimerizável e o solicitado deve ser fotopolimerizável (segue foto da especificação do produto)
	46	Espátula para inserção de compósitos (resina) nº 1	ABC	Não aceita	A proposta de preços da empresa não contempla as exigências de apresentação de catálogo com foto como amostra do produto, vez que não nos foi enviado tal documento.
	47	Espátula para inserção de compósitos (resina) nº 2	ABC	Não aceita	A proposta de preços da empresa não contempla as exigências de apresentação de catálogo com foto como amostra do produto, vez que não nos foi enviado tal documento.
	48	Espátula para inserção de compósitos (resina) nº 3	ABC	Não aceita	A proposta de preços da empresa não contempla as exigências de apresentação de catálogo com foto como amostra do produto, vez que não nos foi enviado tal documento.
	55	Gesso pedra 1 kg	K-DENT	Aceita	Atende às especificações do Edital.



Prefeitura Municipal de

VÁRZEA GRANDE



SECRETARIA DE SAÚDE

Empresa	Item	Descrição	Marca	Situação	Justificativa
SALVI LOPES E CIA LTDA	72	Lima tipo Kerr 1ª série 25 mm tipo flex file (níquel titânio)	ANGELUS PRIMA	Aceita	Atende às especificações do Edital.
	79	Mandril cônico para tiras	PREVEN	Aceita	Atende às especificações do Edital.
	97	Resina foto cor B2 microhíbrida	BIODINÂMICA	Não aceita	A marca não atende às especificações do edital quanto ao tamanho de partículas já que possui uma faixa de 0,04 a 2,2 µm quando o solicitado é média de 0,6 micrômetros (segue foto da especificação do produto)
	98	Resina foto cor C2 microhíbrida	BIODINÂMICA	Não aceita	A marca não atende às especificações do edital quanto ao tamanho de partículas já que possui uma faixa de 0,04 a 2,2 µm quando o solicitado é média de 0,6 micrômetros (segue foto da especificação do produto)
	99	Resina foto cor OA2 nanohíbrida	BIODINÂMICA	Não aceita	Trata-se de resina microhíbrida sendo que a solicitada no edital é a nanohíbrida, (segue foto da especificação do produto)
	100	Resina foto cor OA3 nanohíbrida	BIODINÂMICA	Não aceita	Trata-se de resina microhíbrida sendo que a solicitada no edital é a nanohíbrida, (segue foto da especificação do produto)
	101	Selante de sulcos e fissuras fotopolimerizável	MAQUIRA	Não aceita	O produto não atende ao padrão de qualidade solicitado no edital.



Itens 37 e 38

► Acessórios

- Adesivo Dentário
- Agente De Ligação
- Agentes Condicionantes
- Biomateriais
- Biossegurança
- Cimentos
- Cirúrgicos
- Clareamento
- Compósitos
- Diversos
- Endodontia
- Flo Retrator
- Forradores
- Hiossiliético
- Impressão
- Injetores
- Ionômeros De Vidro
- Espátula Para Ionômero
- Ionglass C
- Ionglass R - A2
- Ionglass R - A3

► Lubrificantes



Código do Produto	Produto	Qtde por Embalagem
040103-4037	Ionômero de Vidro para Restauração - Ionglass Kit A3	01 kit
040103-4008	Ionômero de Vidro para Restauração - Ionglass P6 A3	1 Frasco com 10g
040103-4006	Ionômero de Vidro para Restauração - Ionglass Líquido	1 Frasco com 8g

Apresentação

Ionglass R é um ionômero de vidro autopolimerizável altamente resistente, estável, com viscosidade adequada indicada para trabalhos restauradores. Apresenta excelente biocompatibilidade e baixo risco de sensibilidade pós-operatória. Possui um ótimo selamento marginal na cavidade e inibe a formação de fendas. Pode ser usado na técnica de ATR (tratamento restaurador atraumático), em todas as classes de restaurações de dentes decíduos, restaurações provisórias em dentes permanentes (classes I, II, III e IV), base de restauração definitiva, fissões não cariosas e cimentação provisória de peças protéticas. Ionglass R tem uma boa adesão ao esmalte e a dentina sendo desnecessária a criação de retenções.


Vantagens

- Indicado para todas as classes de restauração (dentes decíduos);
- Cimentação provisória de coroas;
- E um cimento de presa rápida;





Itens 97, 98, 99 e 100.

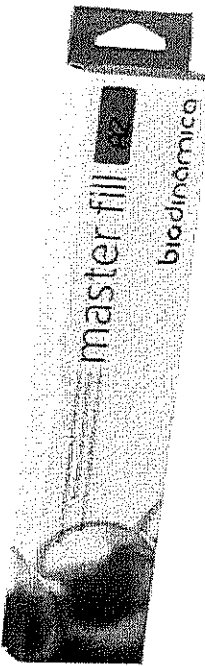Cimentos, Forradores e Vernizes				Indique este produto
Cirurgia e Periodontia				
Controle de Infecção e Descartáveis				
Dentística				
Endodontia				
Ionômeros				
Material de Impressão				
Ortodontia				
Prevenção e Profilaxia				
Retração e Hemostáticos				
Acessórios				
Resina Composta para Restauração Fotopolimerizável				
MASTER FILL é uma resina composta de alta densidade para uso em restaurações de dentes anteriores e posteriores. É um material fotopolimerizável. Possui partículas inorgânicas variando entre 0,04 e 2,2 µm. Apresenta um volume total de carga inorgânica de 79%.				
MASTER FILL apresenta propriedades de fluorescência, excelente acabamento e polimento, assim como ótimas propriedades mecânicas, podendo ser utilizado tanto para restaurações anteriores, inclusive facetas, como para superfícies oclusais.				
O tempo de polimerização é de 40 ± 10 segundos, se utilizado um fotopolimerizador de 400mW (A faixa ótima para fotopolimerizar é de 16 Joules).				
Produtos Relacionados				
				
	MASTER FLOW	MASTER BOND DE	BIOFORTY	ATAQUE GEL